

## Delta-T Devices HH150 Quick Start Guide

**AT**  
Delta-T Devices Ltd




HH150は、SM150KITに付属するSM150T用の読取り専用器です。

HH2のようにデータ保存や温度計測ができませんが、フィールドで目視で土壤水分値を確認することができます。HH2に比べ小さいので持ち運びには便利な物となります。

SM150T使用方法：

- ・土壤表面の石をなるべく取り除いてください。
- ・固い土に挿入する場合は前もって釘等を使ってピンが刺さる穴を開けておいてください。
- ・ロッドが完全に隠れるまでSM150を刺し込んでください。( \* きちんと土と接触しているか確認してください。)
- ・挿入している最中に強い抵抗を感じた場合、石に当たっている可能性があるので位置をずらして挿入して下さい。

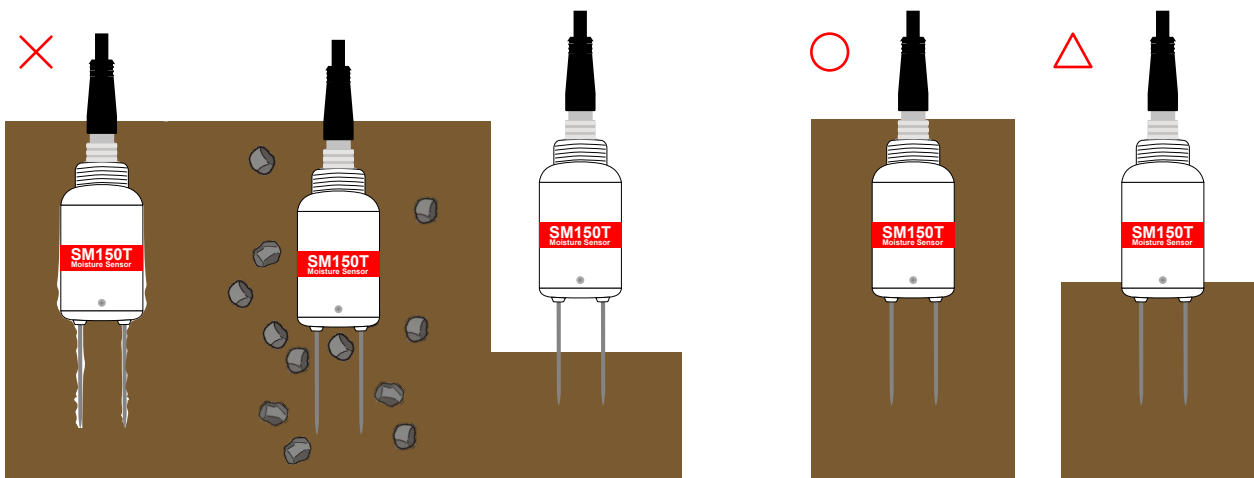


日本環境計測株式会社




〒811-0215  
福岡県福岡市東区高美台二丁目52番42号  
TEL:092-608-6412  
FAX:092-985-7844

## Delta-T Devices HH150 Quick Start Guide

HH150T使用方法:

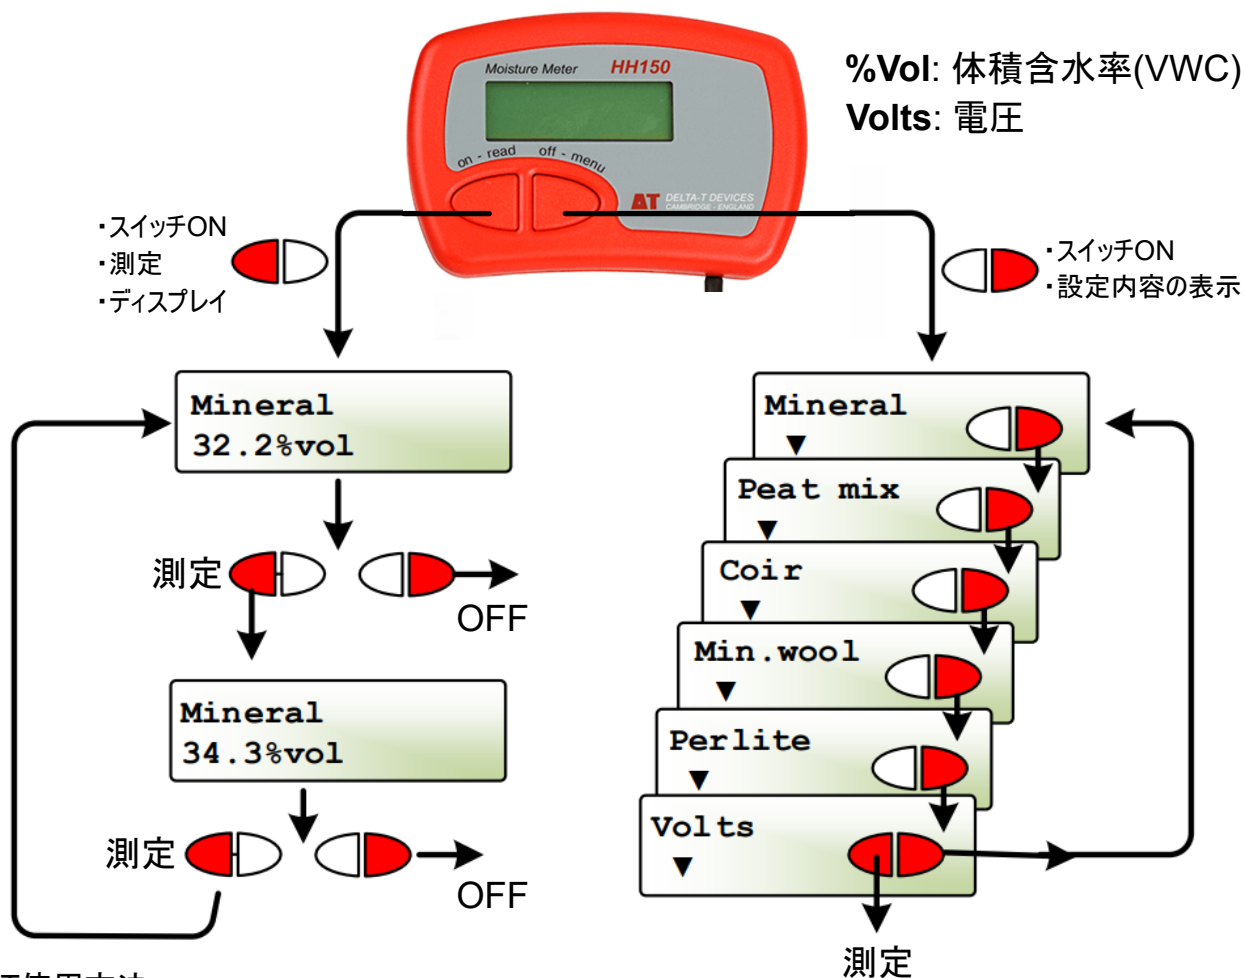

HH150T使用方法:

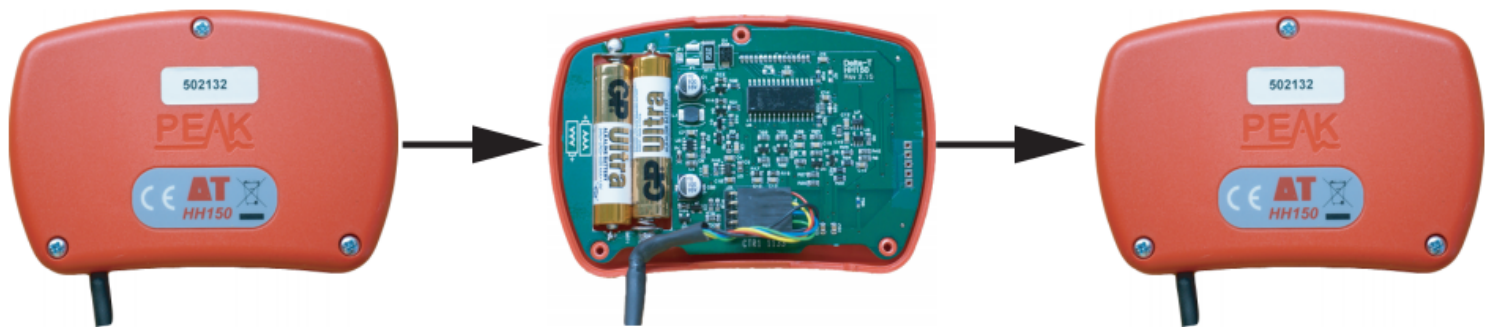

1. 表を下にしてネジを外して電池を取り外してください。

2. 電池を交換してください

3. ケーブルを噛み込まない様に気を付けてバックカバーを付けてください